Wartungsplan NEURO CLASSIC 16 mm mit Passfedern

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

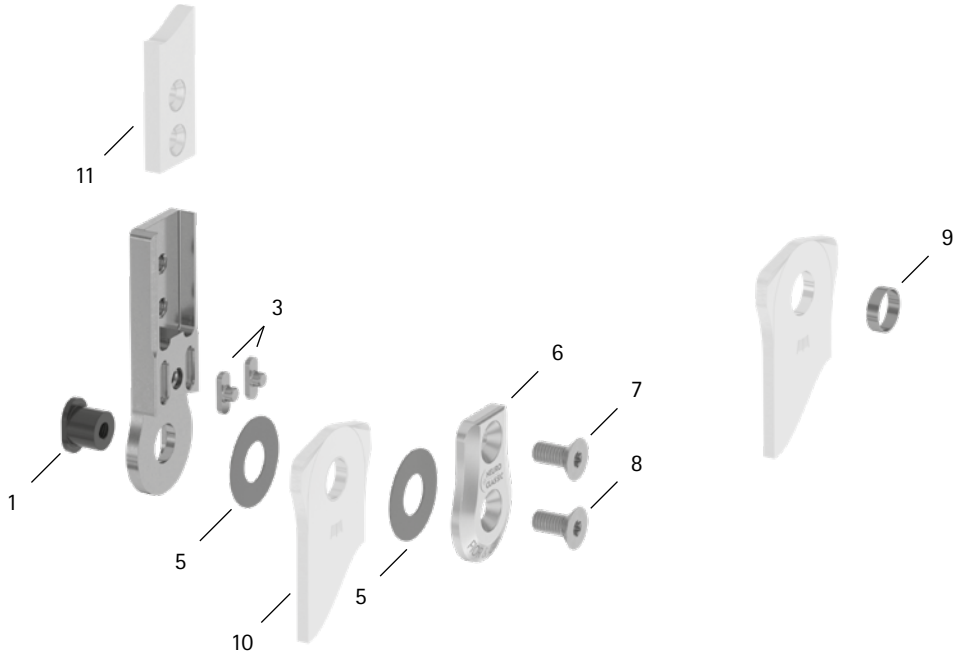

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk mit Passfedern						
1	SB9669-L0710	Splintbolzen, kurz**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0393-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS2210-045					
5	GS2210-050					
5	GS2210-055					
5	GS2210-060					
6	SF0163-AL	Deckplatte**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
1, 6-8	SF1973-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
9	BR1110-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten
** ist Bestandteil der Funktionseinheit
*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar

WP0008-DE-2026-02