


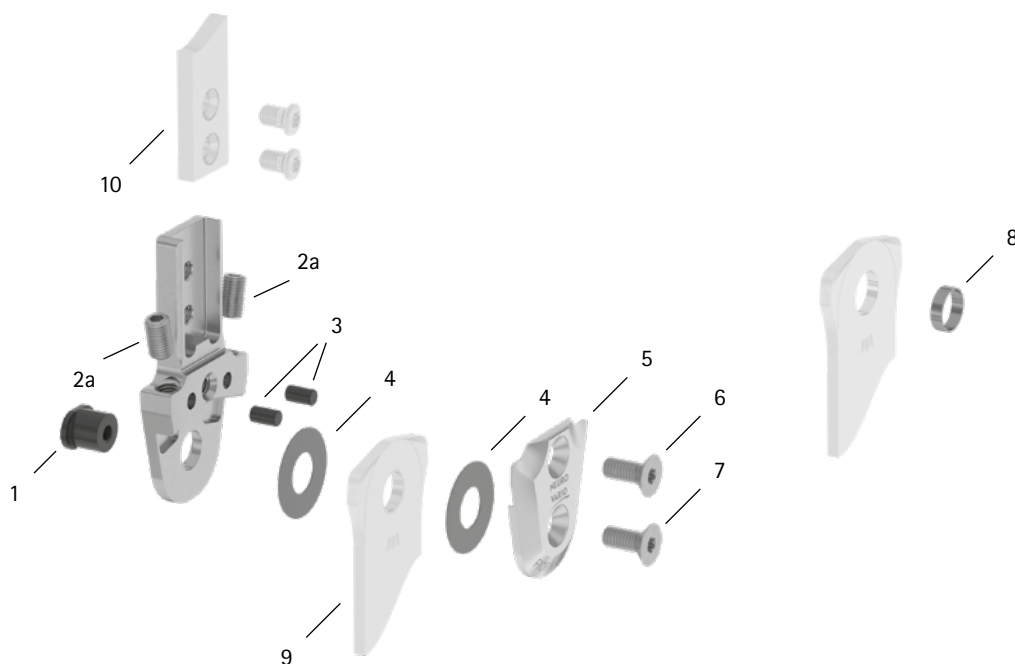

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB9669-L0760	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2a	SC9606-L10ST	Justierschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
3	GS4007	Gewindesicherungsstift	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
4	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2210-045					
4	GS2210-050					
4	GS2210-055					
4	GS2210-060					
5	SF0263-AL	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
8	BR1110-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

WP0009-DE-2023-01