


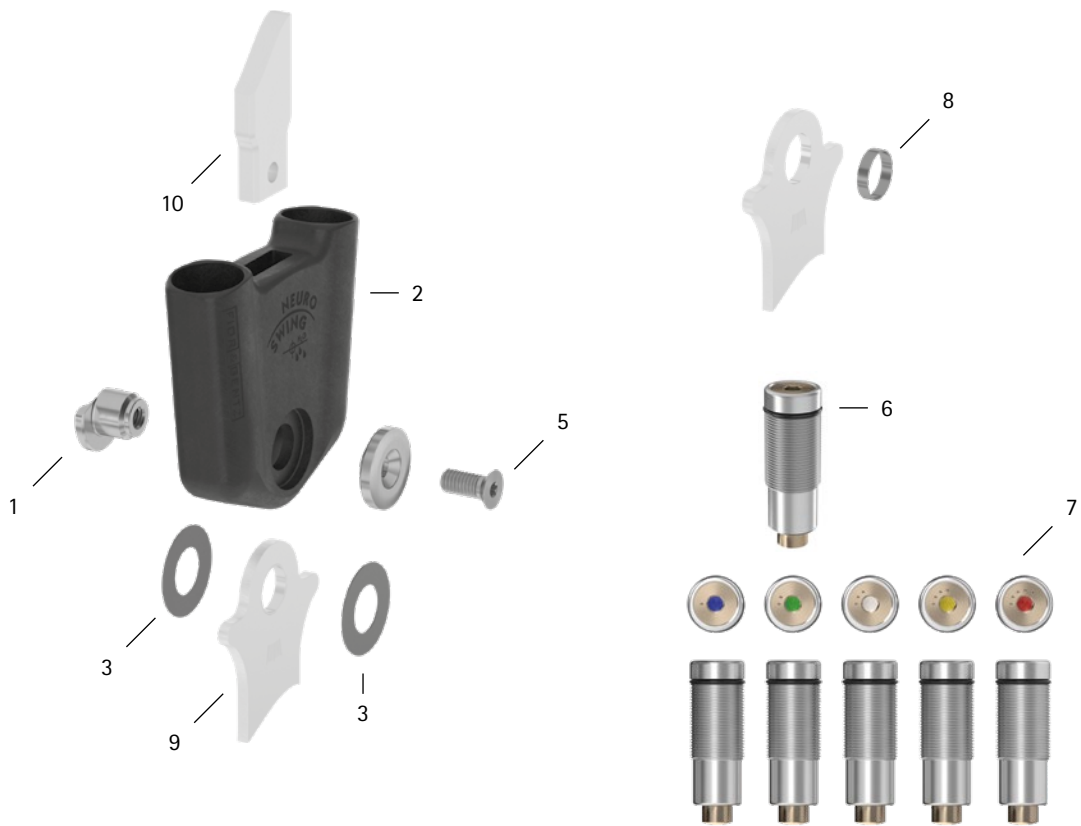

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SF0592-C/1	Splintbolzen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SF0502-C	Gelenkgehäuse	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	GS1911-040	Gleitscheibe, Ø = 19 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1911-045					
3	GS1911-050					
3	GS1911-055					
3	GS1911-060					
5	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Federeinheiten						
6	VE3771-100/12	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5802-C/15/05	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß Geräusche der Federeinheit	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5802-C/15/11	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit				
7	SF5802-C/09/16	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
7	SF5802-C/10/29	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
7	SF5802-C/05/53	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemmanker und Systemschienen						
8	BR1211-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
10	siehe Katalog	Systemmanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
-	-	Klebeverbindung (Systemschiene/Systemmanker und Systemgelenk)	Bruch	neues System- bauteil aus Carbon einkleben	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten